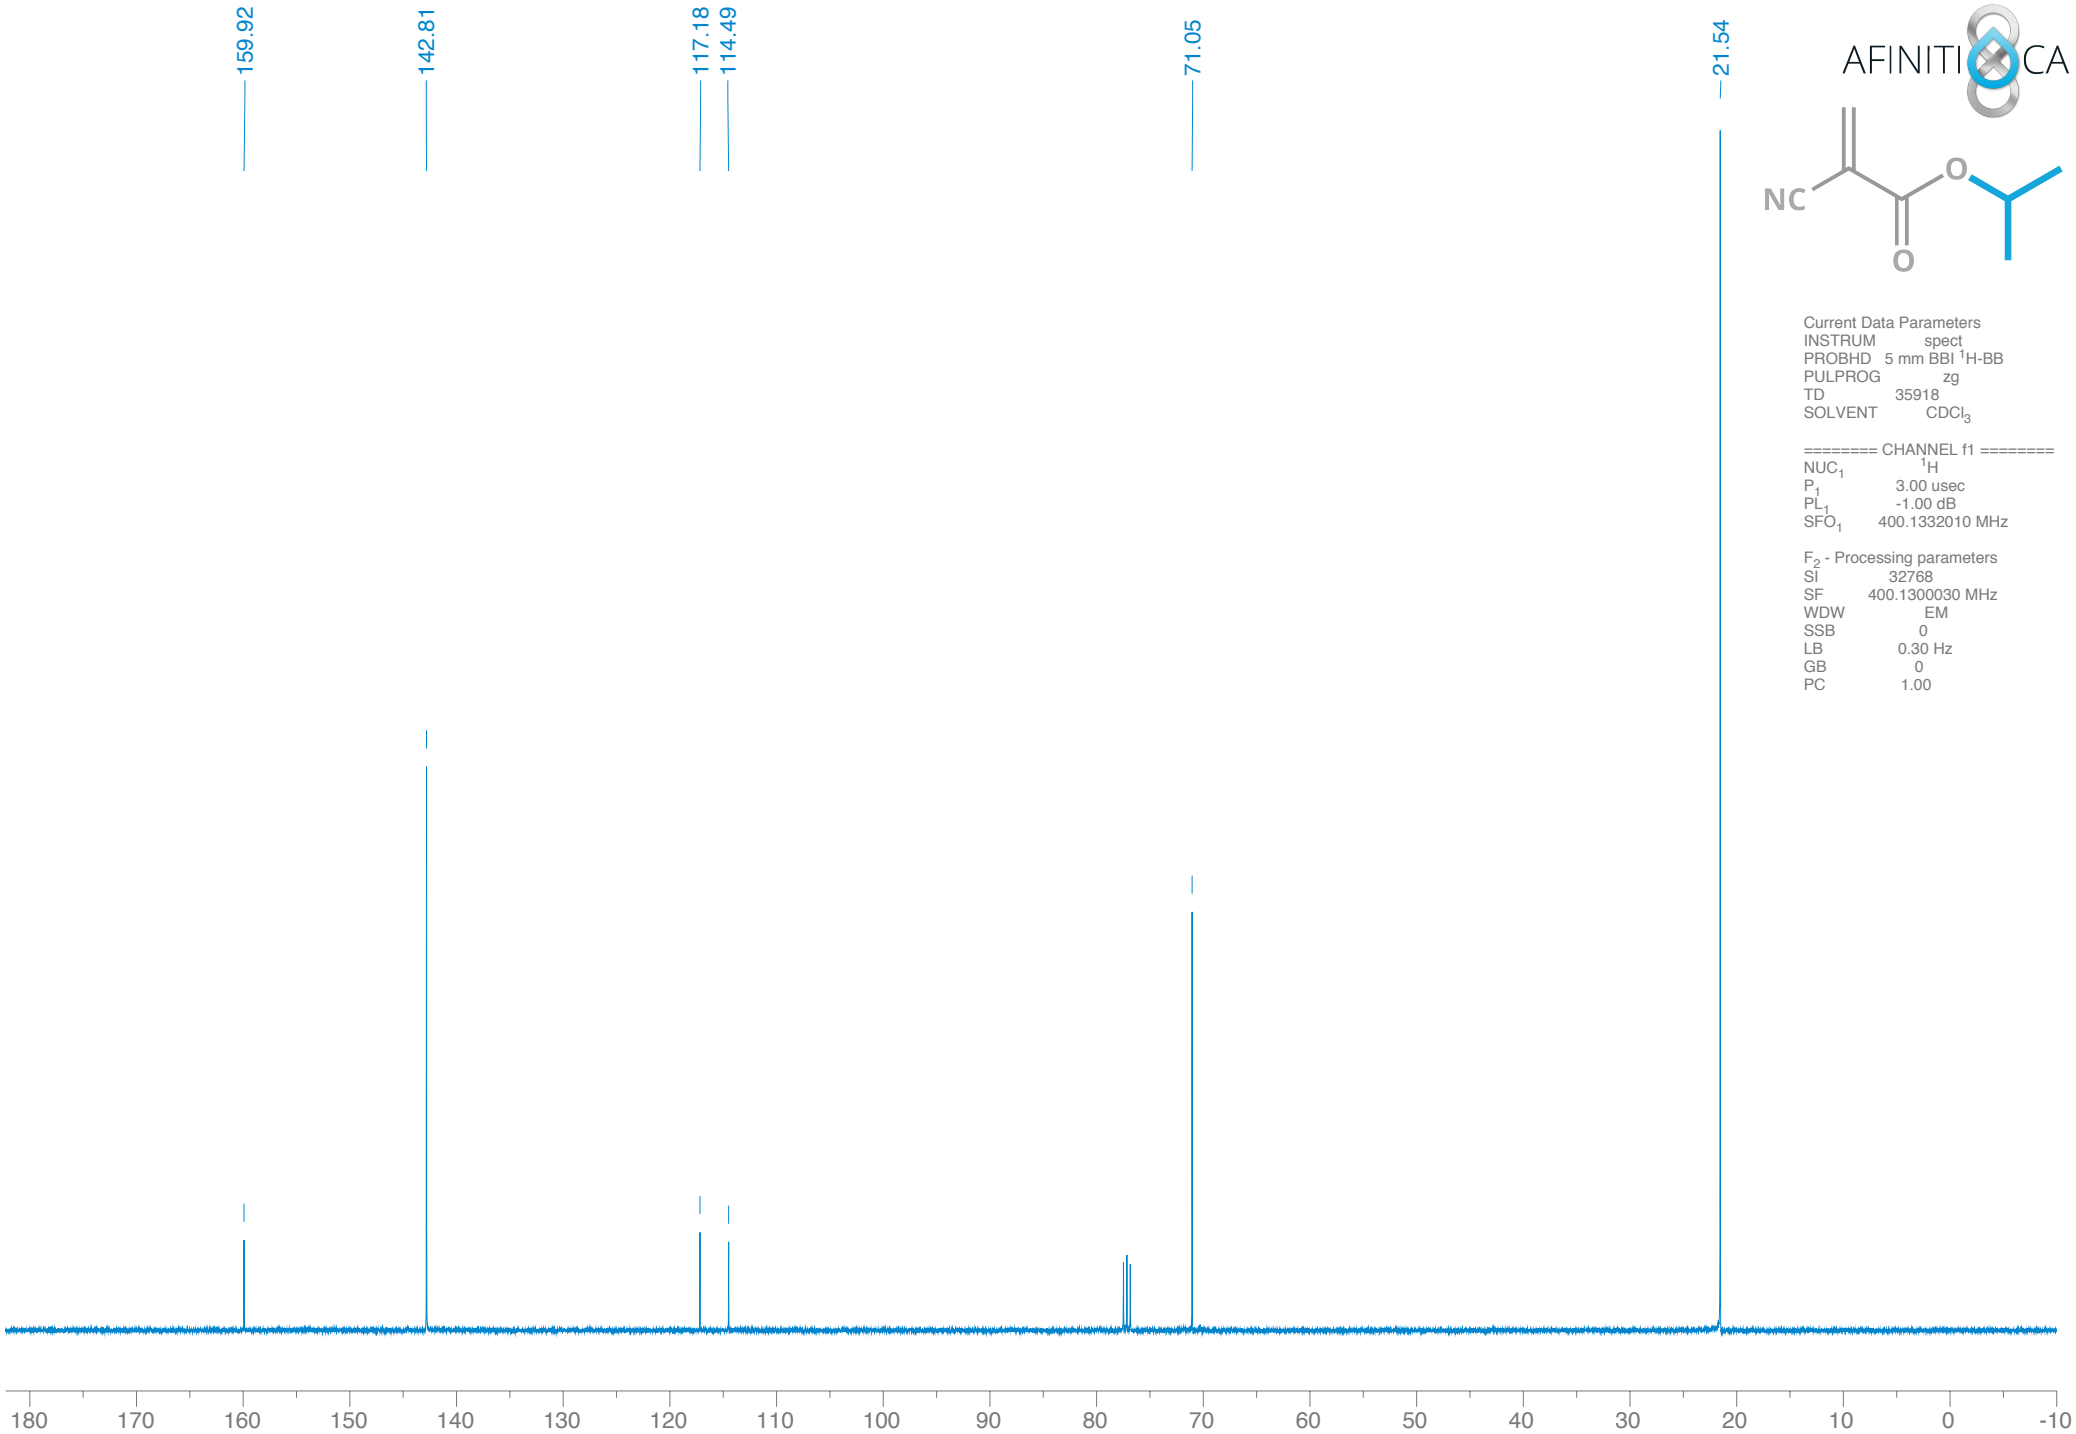

AFINITICA

Current Data Parameters
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm BBI ^{1}H-BB
PULPROG zg
TD 35918
SOLVENT $CDCl_3$

======== CHANNEL f1 ========
NUC_1 ^{1}H
P_1 3.00 usec
PL_1 -1.00 dB
SFO_1 400.1332010 MHz

F_2 - Processing parameters
SI 32768
SF 400.1300030 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00